

Analisi: signora

Centro Assistenza: BABY COMP srl -Italia BABY COMP Srl - Via Vittorio Veneto - 39042 Bressanone (BZ)

Dati di utilizzo

Nome File: _090107_162345.ve

Apparecchio tipo: LadyComp-R

No. di serie: 12295502-16

Data inizio analisi: 17.05.08

Data fine analisi: 07.01.09

Valore temperatura: °C

Anno di nascita: 1983

Altezza [cm]: 156

Peso [kg]: 51

B.M.I. (Body Mass Index) 21.0



Via Vittorio Veneto 79/b
I-39042 Bressanone (BZ)
Tel. +39 0472 831010
Fax +39 0472 832472

Distribuzione dati analoghi


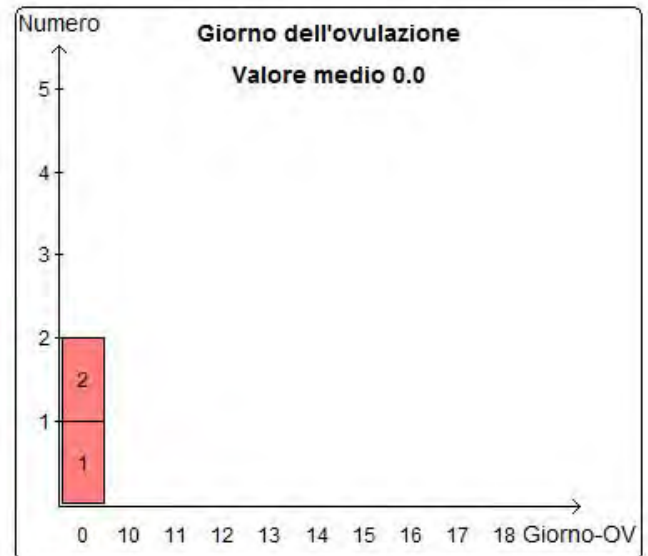


Tabella dei cicli

Ciclo numero C-	Ø	1	2
Misurazioni mancanti in giorni	6.0	5	7
Lunghezza cicli in giorni:	47.0	47	(63)
Giorno dell'ovulazione	--	-	-
Temp. media fase ipotermica	36.40	36.45	36.35
Temp. media fase ipertermica	36.37	36.44	36.29
Diagnosi CLI/PO (1)		PO	-
Pianificazione mirata corretta(2)		-	-
Aumento temp. in fase OV	--	--	--
Lunghezza fase post-OV (HL)	--	--	--

(1) CLI: (Cycle Luteal Insufficiency) Insufficienza fase luteina / PO: Cicli anovulatori

(2) ""+"" = il dato RS (Rapporto Sessuale) e OV (Ovulazione) coincidono

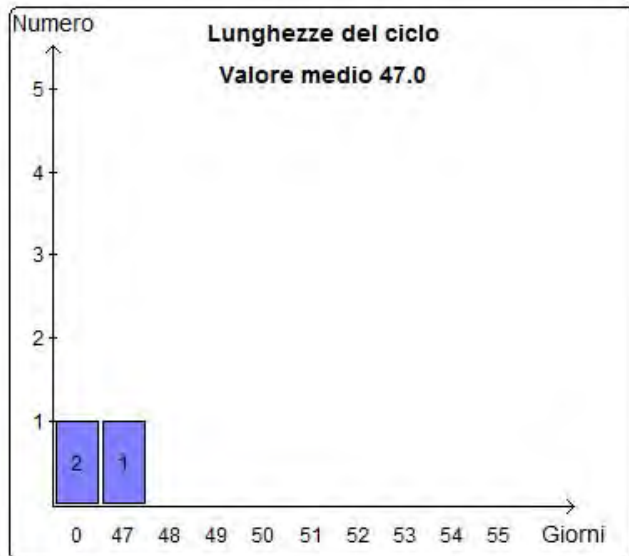